


TOC計(TOC-L CPH) 機器講習会



TOC-L CPH(島津製作所)

試料タイプ	測定タイプ	試料名	試料ID	参照元	結果	注記	仕様	日時
試料	NPOC	ブランク	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.000mg/L			測定済み 2017/09/14
標準液	NPOC	名称未設定	名称未設定	NPOC170914.2017_09_14_12				測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	ブランク	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.1704mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(分5)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.8330mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(PP)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-2.099mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(PPA)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-2.150mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(分5)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-2.355mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(PP)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-2.422mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(分5)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.1704mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802中山試験室超純水(PP)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.1079mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170914中山試験室超純水(分5)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-3.1291mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170914中山試験室超純水(分5)	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-3.9534mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	170802標準室温5ppm	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-4.017mg/L			測定済み 2017/09/14
試料	NPOC	ブランク	名称未設定	NPOC170914.met	NPOC-0.1704mg/L			測定済み 2017/09/14

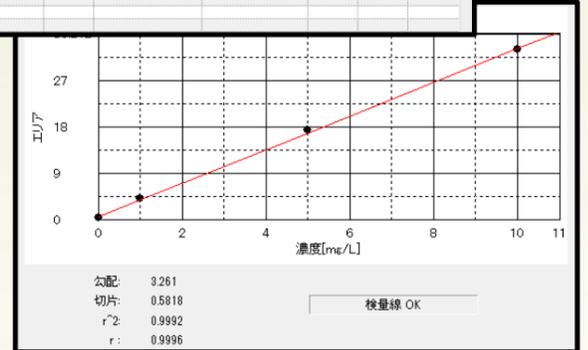

平成29年3月に導入されたTOC計の機器講習会を開催します。
これからTOC計の使用を検討されている方は、是非ご参加ください。

日時：平成29年**10月6日(金)** **13:30~15:30頃**

場所：理系複合棟 310室

機種：TOC-L CPH (島津製作所)

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=53 (分析機器一覧)

講師：泉水 仁 (研究基盤センター)

内容：原理説明と機器の使用方法等

定員：8名

※ 定員に達し次第、受付を終了します。

申し込み方法



予約QRコードもしくは**ホームページ**から

ホームページからの申込の締切りは、

10月5日(木) 15:00まで

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=90

問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室) 泉水 仁

TEL:[895-8967](tel:895-8967) E-mail:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>